



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan :

NOMOR IZIN EDAR

ALAT KESEHATAN

KEMENKES RI AKL 20101916606

Nama Dagang / Merek : **MULTICARE IN Cholesterol**
Kelompok / Kelas Resiko : Diagnostik *In Vitro* / B
Kategori Produk : Peralatan Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik
Sub Kategori : Sistem Tes Kimia Klinik
Jenis Produk : Cholesterol (total) test system (strip & midstream)
Tipe / Ukuran : 3830260
Kemasan : Dus, isi 25 strip
Nama Produsen / Pabrikan : BIOCHEMICAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A., Italy
Nama Pendaftar : PT ISOTEKINDO INTERTAMA, DKI Jakarta
Atas dasar lisensi dari : -

Ketentuan

1. Persetujuan izin edar berlaku
2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
3. Izin edar ini merupakan persetujuan perpanjangan dengan perubahan penandaan dari Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 20101916606 tanggal 19 November 2019. Dengan demikian izin edar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
4. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar.
5. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

Jakarta, 04 April 2024



LABEL KEMASAN PRIMER

Utilizzare con lo strumento
For use with meter
Utiliser avec l'appareil
Debe utilizarse con el instrumento
Για χρήση μόνο με το μετρητή
A se utiliza cu instrumentul
Para utilização exclusiva com o equipamento
Csak készülékhez használható
تستخدم مع الجهاز الإلكتروني لقياس السكر

MULTICAREIN



Per l'autocontrollo / For self testing use
Utiliser pour l'autodiagnostic
Para autodiagnostico
Για αυτοέλεγχο / Pentru auto-testare
Para o auto-controllo
Önmonitorozáshoz
تستخدم للجهاز الذاتي

DATA CHIP

mg/dL mmol/L

Aperto il
Opening date







NORMAL ▶
HIGH ▶
LOT ▶
 ▶

pz/pcs



0344














BSI
DIAGNOSTICS

Biochemical Systems International S.p.A.
 Loc. Palazzo del Pero 23, 52100 AREZZO
 Tel. 0039 0575 984164 - info@biosys.it

MCIN.LBV.9LING.ED2019JUN



KEMASAN SEKUNDER

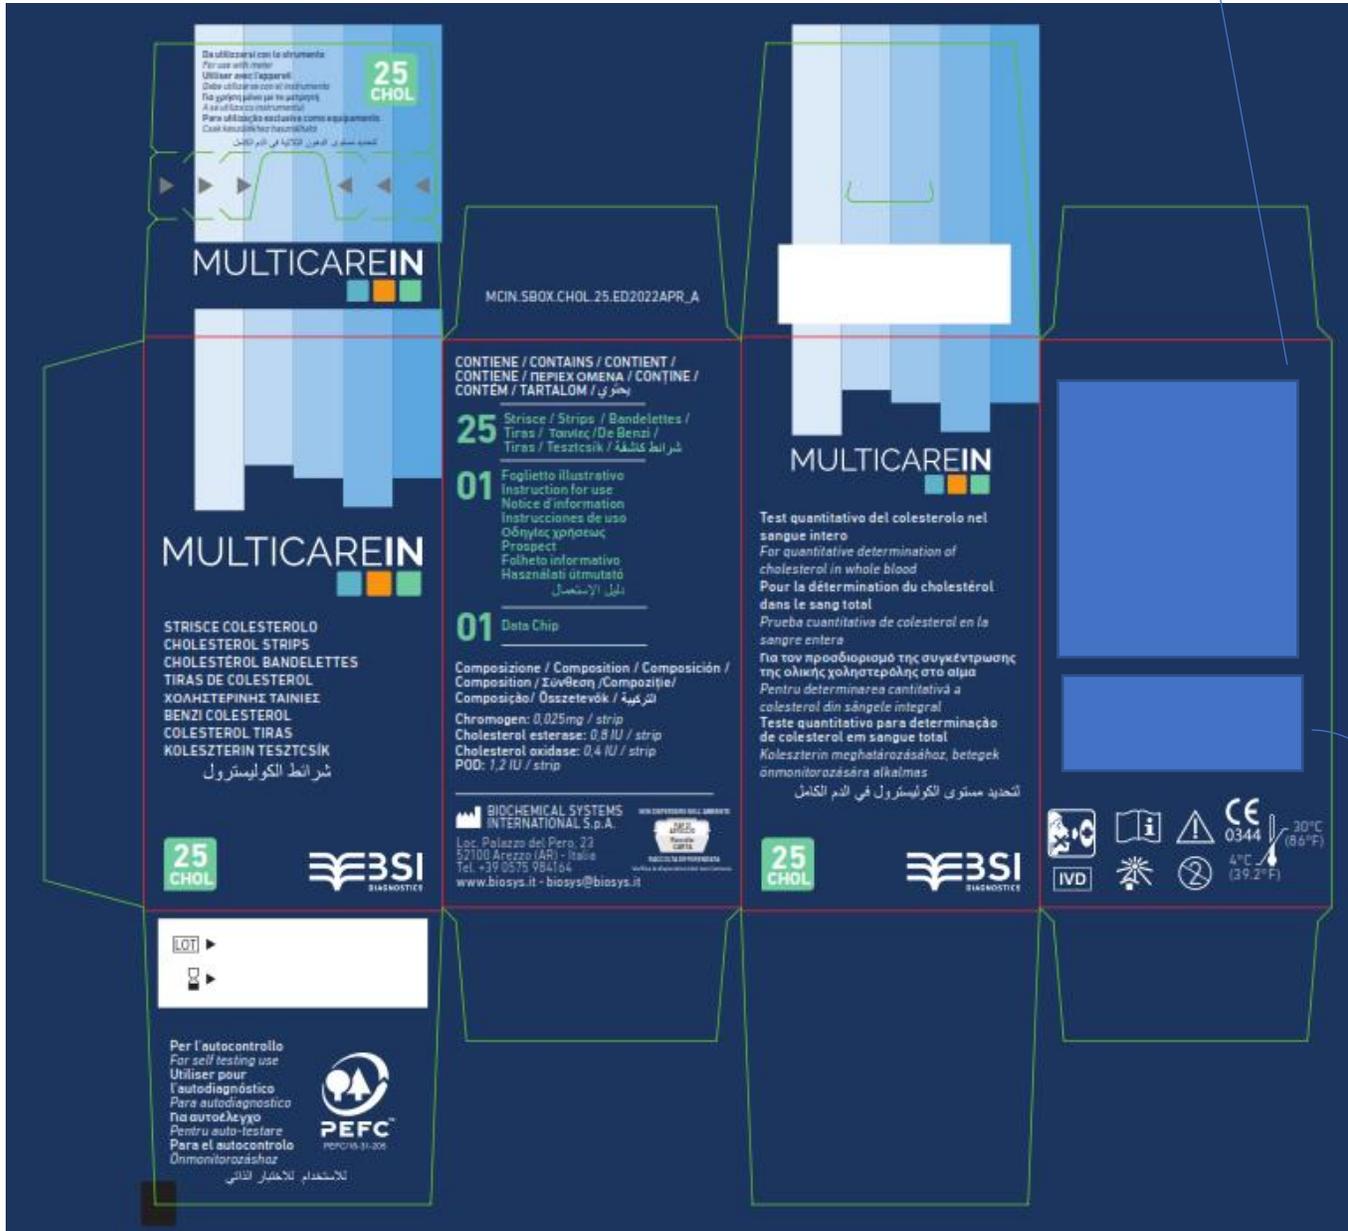

MULTICARE IN Cholesterol Strips
 KEMENKES RI AKL _____
 PT. Isotekindo Intertama
 Jakarta - Indonesia



GAMBAR PRODUK

